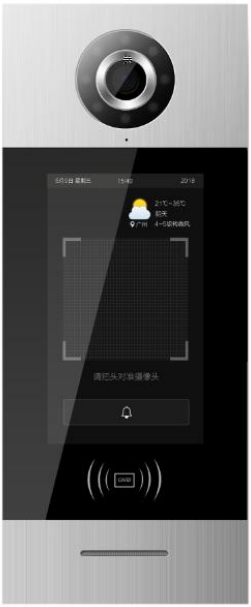

M _V1.0

M-AS01

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；



3、不要使用温布或易挥发性的试剂擦拭设备；

1
1.1 1
1.2 1
2
2.1 2
2.2 3
2.3 4
5
3.1 5
3.2 6
7
4.1 7
4.2 7
4.2.1 7
4.2.2 8
4.3 8
4.3.1 8
4.3.2 9
4.3.3 9
4.3.4 9
10
5.1 10
5.2 11
5.3

6.4 14
6.5 16
6.6 16
..... 17
7.1 17
7.2 18
7.3 18
7.4 19
7.5 19
7.6 20

M TCP/IP

1.1

- **7 TFT**
- **IC**
- **LED**
-
- /
-

1.2

DC 24V 200mA

300mA -10 +55

95%

CMOS 200W

123° 3.5mm

0 lux

LCD 7”

600×1024

(W/H/D) 148.5×363×47 mm

2.1

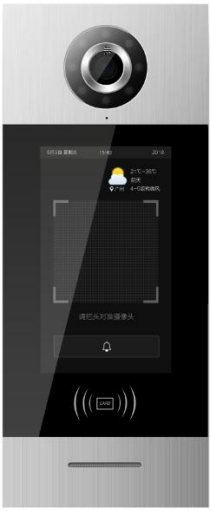

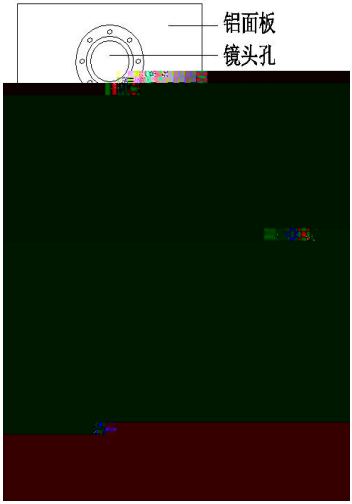

2.2

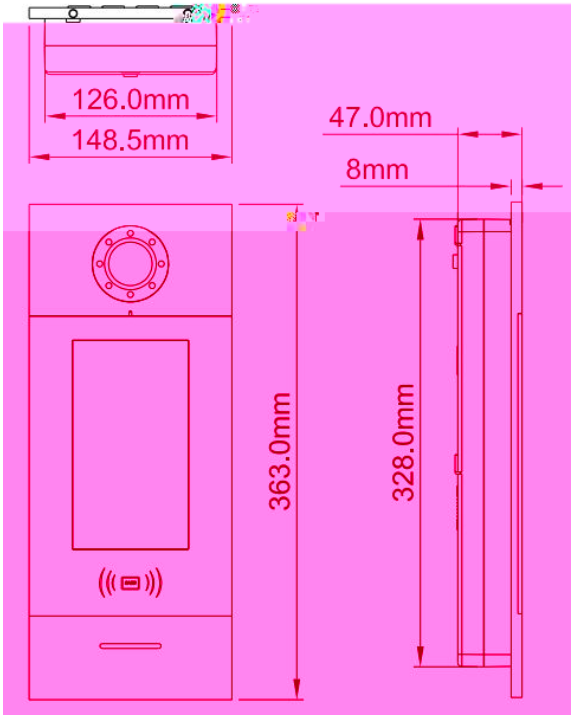

2.3

DC 24V DC 18-30V

+12V >18V

3.1

2

W/H/D 1

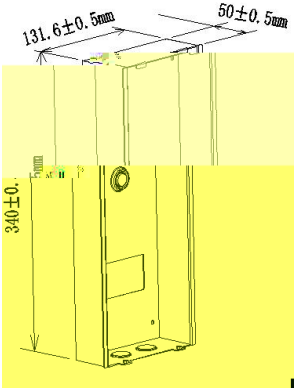
131.6±0.5mm
50±0.5mm
340±0.

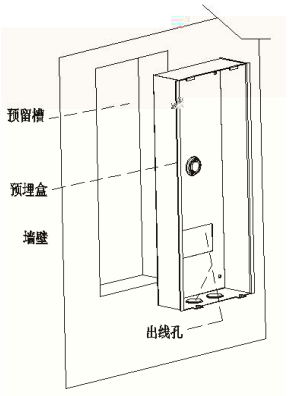
预留槽
预埋盒
墙壁
出线孔

3

4

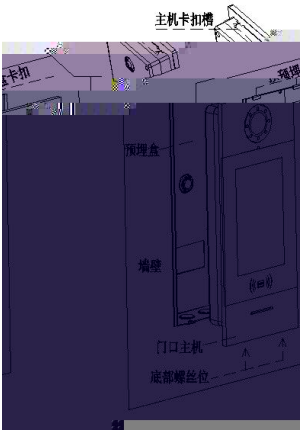
主机卡扣槽
预埋盒
墙壁
门口主机
底部螺丝位

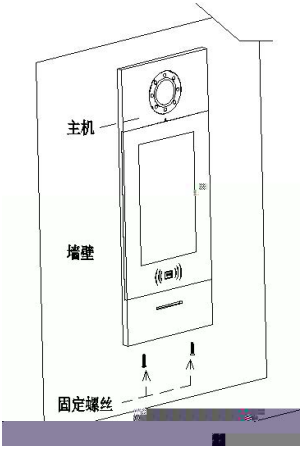
主机
墙壁
固定螺丝

5

3.2

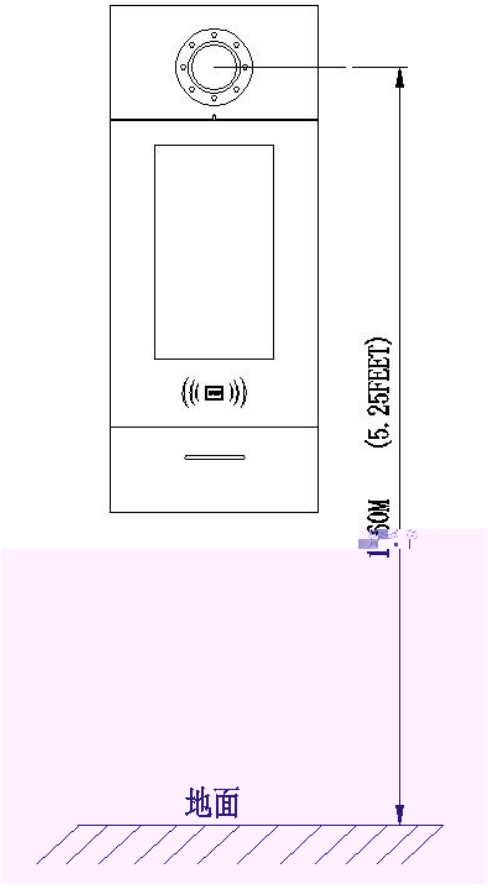

1.6

4.1

4.2

4.2.1

1

2 2718 ——

——

请输入工程密码
密码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
设置
系统设置
工程设置
系统设置
声音设置
日期和时间
开锁设置
门禁卡管理

4.2.2

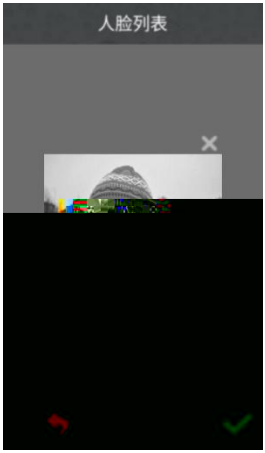
人脸列表

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

1

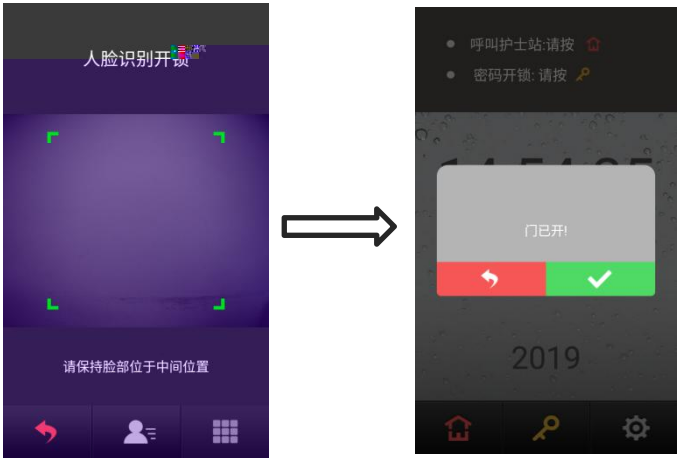

2

3

4.3.4

1

2

请输入公共密码
密码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

3 5678

5.1

呼叫护士站:请按
密码开锁: 请按
11:32:30
08月19日 星期一
2019

5.2

“2718”

5.3

6.1

6.2

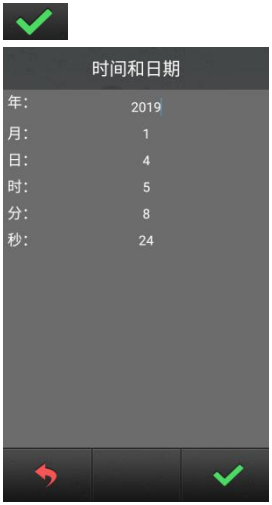

6.3

6.4

●

20000

●

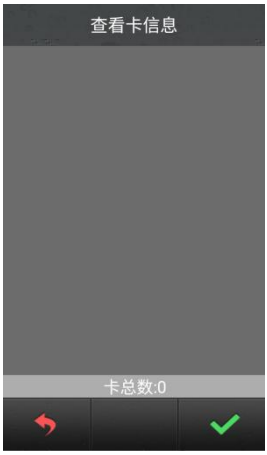
查看卡信息
卡总数:0

●

“ ” “ ”

●

“•”

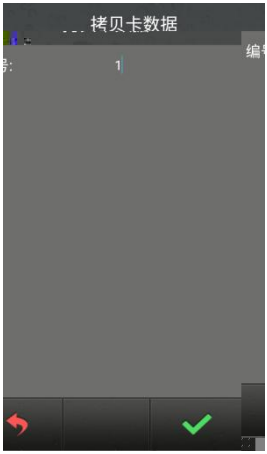
拷贝卡数据
1

6.5

“ ”

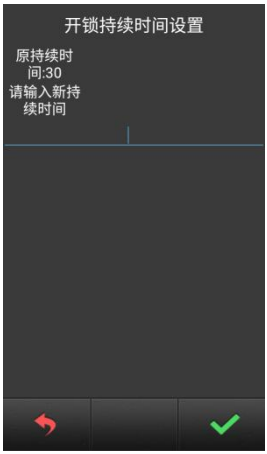

6.6

工程设置
设备属性
出厂测试
工程密码设置
公司信息
版本号
设备授权
升级

7.1

“•” ip

设备属性
设备类型:
病区门口机
服务器: 192.168.195.168
端 口: 8086
设备ip: 192.168.195.117
掩 码: 255.0.0.0
网 关: 192.168.192.2
设备号: 000130

7.2

出厂测试
视频测试
音频测试
触摸屏测试
显示屏测试
铃声测试
通话音测试
指示灯测试
输入端口测试
系统重启
恢复出厂设置

7.3

6

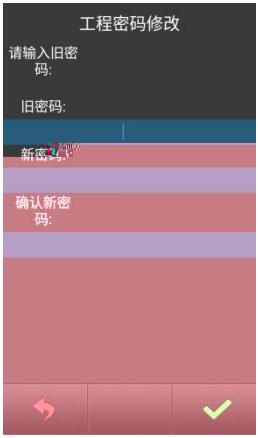
工程密码修改
请输入旧密码:
旧密码:
新密码:
确认新密码:

7.4

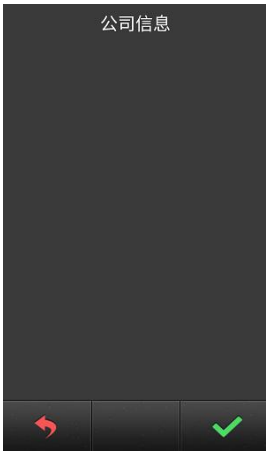
公司信息

7.5

IP MAC

版本号
System Version :
Android6.0.1_V1.03_20190805
Software Version :
V1.03_20190806
MCU :V1.05_20190527
IP : 192.168.195.117
MAC : 1C:87:76:82:06:6F

7.6